


La maintenance Biomédicale dans un centre de dialyse avec la GMAO Qb7



Historique

 2009: Création de Qb7.

« **Q**ualité **B**iologique **7**^{ième} Génération »

 Qb7 est utilisé par trois Associations de Dialyse:
32 établissements




Qb7 GMAO prendre en compte 4 paramètres fondamentaux

Posséder une vision à 360 ° de votre patrimoine

Partager l'information et Manager vos équipements

Meilleure maîtrise

Pérenniser et Protéger votre Patrimoine

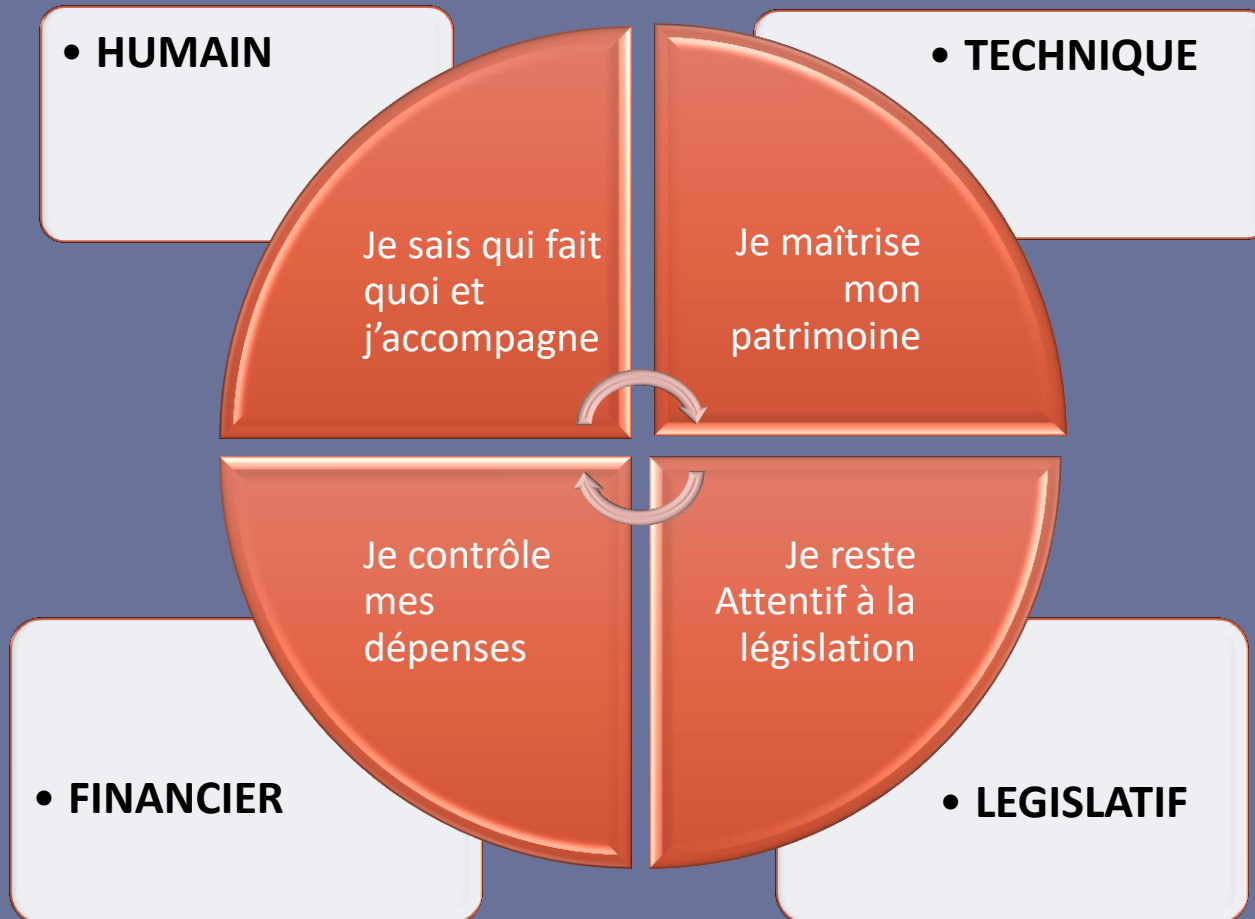

Voici les modules qui composent la **GMAO Qb7**

Gérer mon préventif

Plan de prévention, contrôles externes obligatoire, travaux

Gérer mon patrimoine bâtiment/locaux/services

Gérer mon curatif d'interventions équipements multi-domaines

Qb7
GMAO

Gérer mes équipements

Biomédical, Génie Civil, informatique

Piloter mon activité Analyse, statistique et comptes rendus

Gérer ma logistique

Stock, Commande, Fournisseur.


Gérer mon système qualité GDR, GED, Evènement Indésirable, Certification H.A.S

La GMAO est votre outils du quotidien pour atteindre **vos Objectifs**







- La sécurité du patient.
- La continuité des soins.
- Normalisation et Identification des procédures et processus
- La Gestion des Risques et des évènements Indésirable
- La Maintenance Curative, Préventive des DM.
- La mise en application des textes réglementaires.
- L'inventaire des équipements utilisés et la traçabilité totale en lien avec le RSQM
- La gestion de vos achats / consommations

Le Module équipement Qb7 dédiée à votre METIER



1602 - GENERATEUR DE DIALYSE

Dispositif médical
Marque : Fresenius medical care
Modèle : 4008S


Pôle : Intra Bat 
Bâtiment : 102 - Pavillon 102 
UF : 7102 - Pavillon 102 
Local : 1253 Salle de soins 


Quantité : 1
Compteur : 5560 - Relevé le 03/11/16
Etat : Bon


date de mise en fonction:

CNEH : GENERATEUR / MONITEUR INDIVIDUEL D
Code : 40001 Ctrl ext obligatoire : Oui
Classe de risque : IIb Ctrl int obligatoire : Oui
Règle d'application : R.11 Vis prév obligatoire : Oui


S/N : XF562IB
N°. interne : 1602
N° GBM : Non précisé



2 001000 060153 



Permalink



■ Immobilisé en curratif
■ Immobilisé en preventif
■ En prêt
■ Réservé

<< < **Novembre 2016** > >>

Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me	J	V	S	D	L	Ma	Me
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

- Caractéristiques
- CNEH
- Réservation
- Intervention
- Maintenance
- Finance
- Liaison documentaire
- Suivi
- Liaison technique
- Contrat

Le Module équipement Qb7 dédiée à votre

METIER



Equipements

- Caractéristiques
- CNEH
- Réservation
- Intervention
- Maintenance
- Finance
- Liaison documentaire
- Suivi
- Liaison technique
- Contrat

Intervention(s)



04/11/24 : ID 2475 Visite Préventive biomédicale - BOUVARD
Intra Bat / 7102 - Pavillon 102 - Visite selon la gamme opératoire en vigueur

03/11/23 : ID 2474 Visite Préventive biomédicale - BOUVARD
Intra Bat / 7102 - Pavillon 102 - Visite selon la gamme opératoire en vigueur

03/11/22 : ID 2473 Visite Préventive biomédicale - BOUVARD
Intra Bat / 7102 - Pavillon 102 - Visite selon la gamme opératoire en vigueur

03/11/21 : ID 2472 Visite Préventive biomédicale - BOUVARD
Intra Bat / 7102 - Pavillon 102 - Visite selon la gamme opératoire en vigueur

03/11/20 : ID 2471 Visite Préventive biomédicale - BOUVARD
Intra Bat / 7102 - Pavillon 102 - Visite selon la gamme opératoire en vigueur

04/11/19 : ID 2470 Visite Préventive biomédicale - BOUVARD
Intra Bat / 7102 - Pavillon 102 - Visite selon la gamme opératoire en vigueur

05/11/18 : ID 2469 Visite Préventive biomédicale - BOUVARD
Intra Bat / 7102 - Pavillon 102 - Visite selon la gamme opératoire en vigueur

03/11/17 : ID 2468 Visite Préventive biomédicale - BOUVARD
Intra Bat / 7102 - Pavillon 102 - Visite selon la gamme opératoire en vigueur

05/06/16 : ID 1761 Panne biomedical - ALCARRIA 120 ?
Intra Bat / 7102 - Pavillon 102 - En panne


SMQ

9 interventions (3.70 /an)
Indisponibilité (délai du curatif) : 0 j

Coût curatif : 120,00 ? TTC
Coût préventif : 0 ? TTC


	Curatif	Préventif	Contrôles	Travaux	Interne	Externe	Total
Nb	1	8	0	0	9	0	9
Nb / an	0.41	3.29	0	0	3.70	0	3.70
Temps (H)	2	0	0	0	2	0	2
Temps / an	0.82	0	0	0	0.82	0	0.82
Coûts (?)	120,00	0	0	0	120,00	0	120,00
Coûts / an	49,30	0	0	0	49,30	0	49,30

Le Module équipement Qb7 dédiée à votre METIER



- Caractéristiques
- CNEH
- Réservation
- Intervention
- Maintenance
- Finance
- Liaison documentaire
- Suivi
- Liaison technique
- Contrat

	2015	2016	2017
€ BI curatifs	0	240	0
€ contrats cur.	0	0	0
€ BI préventifs	0	0	0
€ contrats prév.	200	200	200
€ contrats TR	0	0	0
€ Totaux	200	440	200

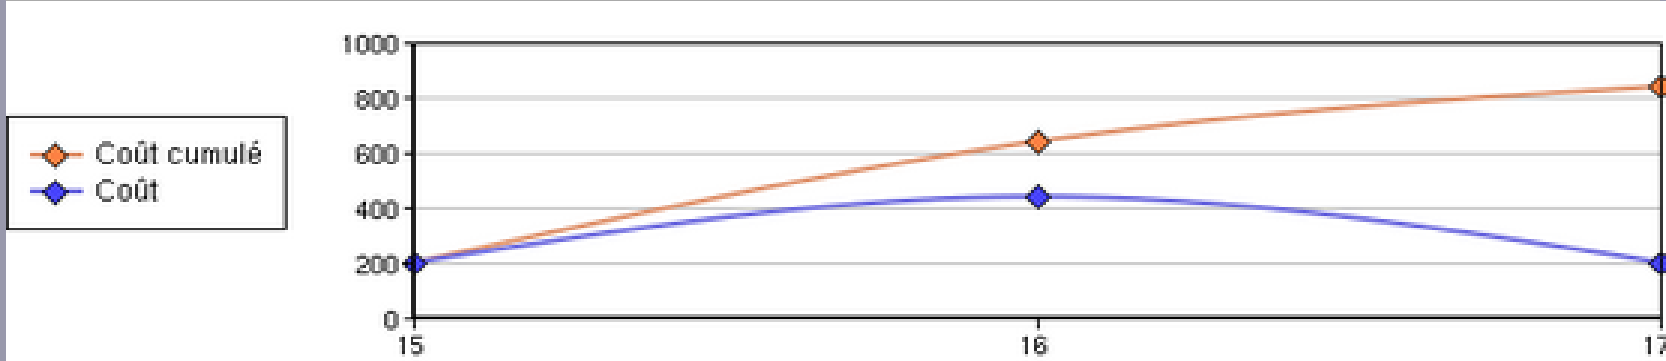

⊗ NB : Le coût des contrats est réparti sur leurs durées
 ⊗ NB : Les coûts sont TTC

Coût total : 840,00 € TTC
 (702,34 € HT)

Risque patient : 4
 Risque technique : 3
 Risque financier : 4
 Moyenne : 3,67

Coût du préventif : 600,00 € (Contrats : 600,00 € / Pièces : 0 € / Tech : 0 € / BI : 0 €)
 Coût du curatif : 120,00 € (Contrats : 0 € / Pièces : 0 € / Tech : 120,00 € / BI : 0 €)

Le Module équipement Qb7 dédiée à votre METIER



Equipements

Finances

Acheté le 31/05/14 : 5 000,00 € HT

Facture n° 5626-XD

Imputation comptable : 9508465

Mis en fonction le 31/05/14

Durée d'amortissement : 6 ans

Montant amortissement annuel : 1 000,00 € TTC

Durée de la garantie : 2 ans

Fin de maintenance le 30/07/25

Coût total du SAV : 720,00 € TTC

Indice coût de maintenance : 6

Coût normal de la maintenance : 360,00 € TTC

Indice de risque : 1,50

Valeur de risque : 9 000,00 € TTC

Renouvellement à prévoir : le 28/05/24

Amortissement ou durée d'exploitation

Documents



MODE OPÉRATOIRE : 013-2 Mise à disposition Materiel.xlsx [↔](#)



MODE OPÉRATOIRE : 038-1 Gestion des fournitures.doc [↔](#)



IMAGE JPG : photo augereau [↔](#)

Historique des localisations

03-11-2016 à 16:32 : Pôle = Intra Bat UF = 7102 - Pavillon 102 Local = 1253 Salle de soins

- Caractéristiques
- CNEH
- Réservation
- Intervention
- Maintenance
- Finance
- Liaison documentaire
- Suivi
- Liaison technique
- Contrat

Le Module équipement Qb7 dédiée à votre METIER



Equipements

Intervenants

Fournisseurs / Intervenants externes :

HIE EQUIPEMENT - SAINT EGREVE (Tel 04 76 87 13 81)

SASIC (M.PAPOZ) (Tel 04 76 52 02 20) (Sous-traitant)

Intervenants internes :

Du 31/05/14 au 04/11/16 - CVC-DEBZA Yahia

Du 31/05/14 au 04/11/16 - CARMASSI Armand

Liaisons

Equipement principal lié

ID 1601 - Lit - S/N

Sous-équipement lié

ID 4176 - Coffret normal secours - S/N NC

Pieces et consommables liés

ID 221 - : (1) Anti-retour mini - Ref 100218011 (4 en stock) Cmd

ID 82 - HIE EQUIPEMENT : (1) Tete de pompe engrenage FRES - Ref 6751421 (18 en stock (+1)) Cmd

Maintenance

Contrat(s)

ID 14 - Contrat n° - - Fin le 24/05/17 - 600,00 € / 2.0 ans

- Caractéristiques
- CNEH
- Réservation
- Intervention
- Maintenance
- Finance
- Liaison documentaire
- Suivi
- Liaison technique
- Contrat

Le Module Qualité Qb7 dédiée à votre METIER



Menu qualité

Cartographie des risques.

- Gestion Documentaire
- Gestion des évènements indésirables.
- Gestion des Risques
- Analyse
- Prise de décision
- Gestion de projet
- Certification HAS
- RAQ
- Législatif

RECHERCHE PRECISE

sur : Documents

Dans: Rechercher
Tous les champs ? Sugg.

Et dans: Rechercher
Tous les champs ? Sugg.

Et dans: Rechercher
Tous les champs ? Sugg.

Classer par: Approbateur. Ordre inverse

Puis par: Approbateur. Ordre inverse

Puis par: Approbateur. Ordre inverse

Créer une nouvelle recherche prédéfinie

Entrez un nom

Modifier une recherche prédéfinie

Le Module Qualité Qb7 dédiée à votre METIER



Menu qualité

Cartographie des risques.

- Gestion Documentaire
- Gestion des évènements indésirables.
- Gestion des Risques
- Analyse
- Prise de décision
- Gestion de projet
- Certification HAS
- RAQ
- Législatif

Processus
Processus 01 Qualité
Processus 02 Organisation de la prise en charge du patient
Sous-processus 01 Politique
Sous-processus 02 Accueil Consultation
10204 <input type="checkbox"/> Procédure accueil DP V1 (Procédure)
10550 <input type="checkbox"/> Accueil patient Détail de la partie : « Accueil Infos Accord » V1 (Mode opératoire)
10052 <input type="checkbox"/> Accueil patient yolande V1 (Mode opératoire)
10053 <input checked="" type="checkbox"/> Accueil secrétariat V1 (Mode opératoire)
Sous-processus 03 Diagnostic
10799 <input type="checkbox"/> Stratégies Le résultat de 2 processus différents face à la maladie V1 (Fiche technique)
10194 <input type="checkbox"/> Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne
Sous-processus 04 Soins
10195 <input type="checkbox"/> Synthèse de Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique che
10049 <input type="checkbox"/> Pre-accueil et accueil psychologique du patient V1 (Document divers)
Sous-processus 05 Paramédical
Sous-processus 06 Interface
Sous-processus 07 Droits et information du patient
10427 <input type="checkbox"/> Logigramme de l'accueil d'un patient n'ayant pas des droits ouverts à la sécurité V1 (Proc
10826 <input type="checkbox"/> PPacc-D.001 - Livret d'accueil patient V1 (Document divers)
Sous-processus 08 Sortie
Sous-processus 09 Urgences vitales
Processus 03 Hygiène et vigilances sanitaires
Processus 04 Biomédical
Processus 05 Circuit du médicament

Le Module Qualité Qb7 dédiée à votre METIER



Menu qualité

Cartographie des risques.

- Gestion Documentaire
- Gestion des évènements indésirables.
- Gestion des Risques
- Analyse
- Prise de décision
- Gestion de projet
- Certification HAS
- RAQ
- Législatif

Identification Workflow-FEI Analyse Actions EI

CRITICITÉ : ACCEPTABLE

Nom du risque Absence de dépistage régulier:(SAMR/ BMR Porteur de KT Suivi des sérologies HBV HIV !

Identificateur

Catégorie Cartographie des risques

Disponible dans les FEI ?
Oui : Non :

Thème PRISE en CHARGE PATIENT

Sous-thème Risques Infectieux

Etape

Sous-étape

Situation à risque

PERSONNES EXPOSÉES

Concerne tout l'établissement OU Concerne toutes les professions

Pôle

UF

Local

Profession

Profession

Profession

Profession

Profession

Nombre de personnes exposées 0

Le Module Qualité Qb7 dédiée à votre METIER



Menu qualité

Cartographie des risques.

- Gestion Documentaire
- Gestion des évènements indésirables.
- Gestion des Risques
- Analyse
- Prise de décision
- Gestion de projet
- Certification HAS
- RAQ
- Législatif

Identification Workflow-FEI **Analyse** Actions EI

Risque : Absence de dépistage régulier:(SAMR/ BMR Porteur de KT Suivi des sérologies HBV HIV)

Statut
Processus
Sous-process *Choisissez d'abord un processus*
Risque

Vous êtes sur le risque 1115
Projet associé 11377

CRITICITÉ : ACCEPTABLE

	Gravité	Occurrence	Non utilisé 1	Autre	Total
Initiale	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	1
Calculée	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	9
Actuelle	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	9

COMPLEMENT D'INFORMATION

Pilote **PARTICIPANTS**

Le Module Qualité Qb7 dédiée à votre METIER



Menu qualité

Cartographie des risques.

- Gestion Documentaire
- Gestion des évènements indésirables.
- Gestion des Risques
- Analyse
- Prise de décision
- Gestion de projet
- Certification HAS
- RAQ
- Législatif

PROJET

PROJET : NOUVEAU RISQUE
Id 3134
Version : 1

Domaine : Vigilance

1358 demonstration
Wiever DWG
Wiever IFC/BIM
Création 07/07/2016
Dernière modif. 07/07/2016
Dernier upload NC
Application NC
Freq. de révision Annuelle

Analyse

Projet n°3134
STATUT : Analyse en cours

<u>CRITICITÉ</u>	G	F	D	A	Total
Initiale					
Calculée					
Actuelle					—

Participants : Aucun
Méthode d'analyse : Non précisé

RESULTATS
Non rédigé

Le Module Qualité Qb7 dédiée à votre METIER





Menu qualité




Cartographie des risques.



- Gestion Documentaire
- Gestion des évènements indésirables.
- Gestion des Risques
- Analyse
- Prise de décision
- Gestion de projet
- Certification HAS
- RAQ
- Législatif




SYNTHÈSE CHAPITRE 1





1 - La stratégie de l'établissement



1.a - Valeurs, missions et stratégie de l'établissement  




 ACT ACT  EVA  COM



1.b - Engagement dans le développement durable  







 ACT ACT COM  NEU NEU  ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT



 PCP ACT ACT ACT ACT ACT  COM COM COM COM  EVA  ACT





1.c - Démarche éthique  



  DOC DOC  COM






1.d - Politique des droits des patients  



 ACT  FOR  EVA  DOC  FOR  ACT



1.e - Politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins  


 ACT ACT ACT ACT  ACT ACT ACT  PCP  COM


1.f - Politique et organisation de l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)  


 PCP ACT ACT  NEU NEU NEU NEU  COM COM  NEU NEU NEU  PCP PCP PCP PCP PCP


1.g - Développement d'une culture qualité et sécurité  


 COM  COM COM COM


B 


B 

B 

A 

B 

B 

B 

La fonctionnalité Indicateur dans Qb7 dédiée à votre METIER




Indicateur qualité

- Document
- GDR
- Analyse
- Evènement indésirable.

Indicateur de gestion technique

- Interventions
- Plannings
- Service demandeur

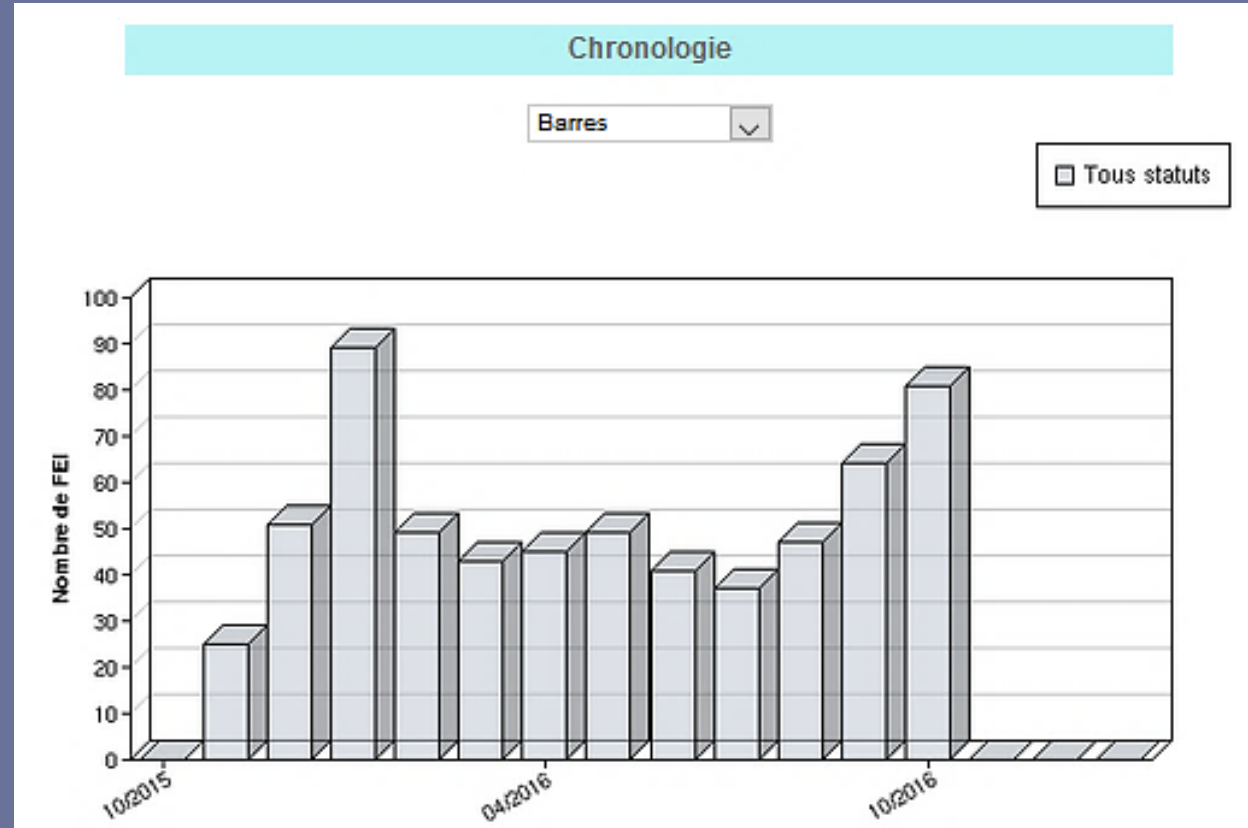

La fonctionnalité Indicateur dans Qb7 dédiée à votre METIER




Indicateur qualité

- Document
- GDR
- Analyse
- Evènement indésirable.

Indicateur de gestion technique

- Interventions
- Plannings
- Service demandeur

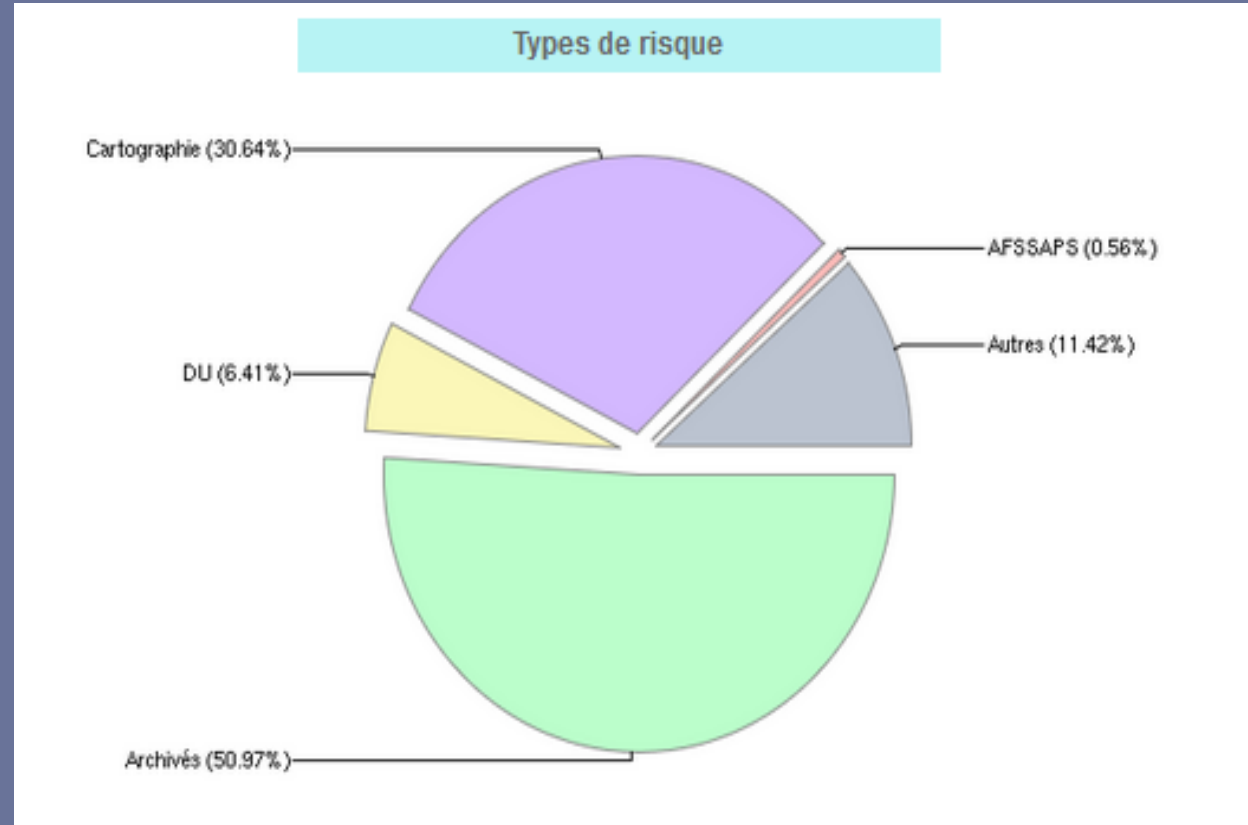

La fonctionnalité Indicateur dans Qb7 dédiée à votre METIER




Indicateur qualité

- Document
- GDR
- Analyse
- Evènement indésirable.

Indicateur de gestion technique

- Interventions
- Plannings
- Service demandeur

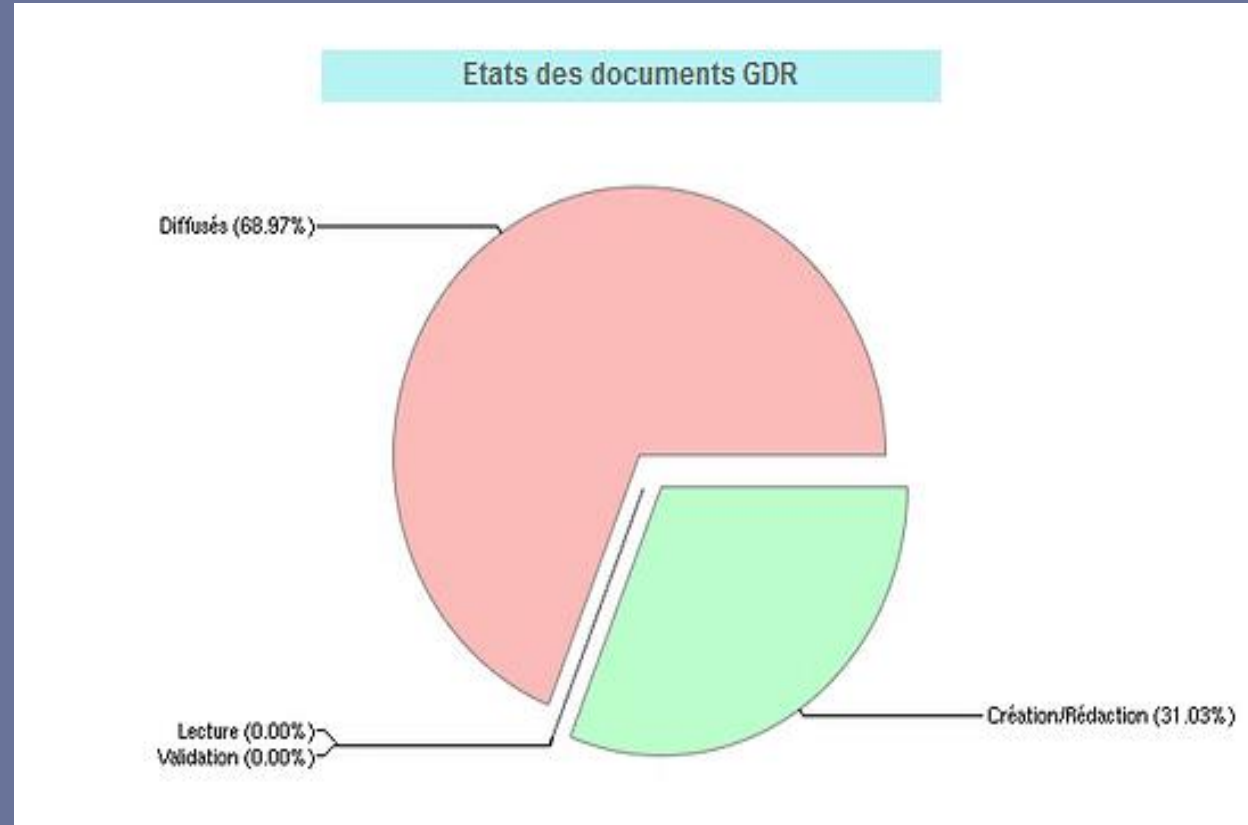

La fonctionnalité Indicateur dans Qb7 dédiée à votre METIER




Indicateur qualité

- Document
- GDR
- Analyse
- Evènement indésirable.

Indicateur de gestion technique

- Interventions
- Plannings
- Service demandeur

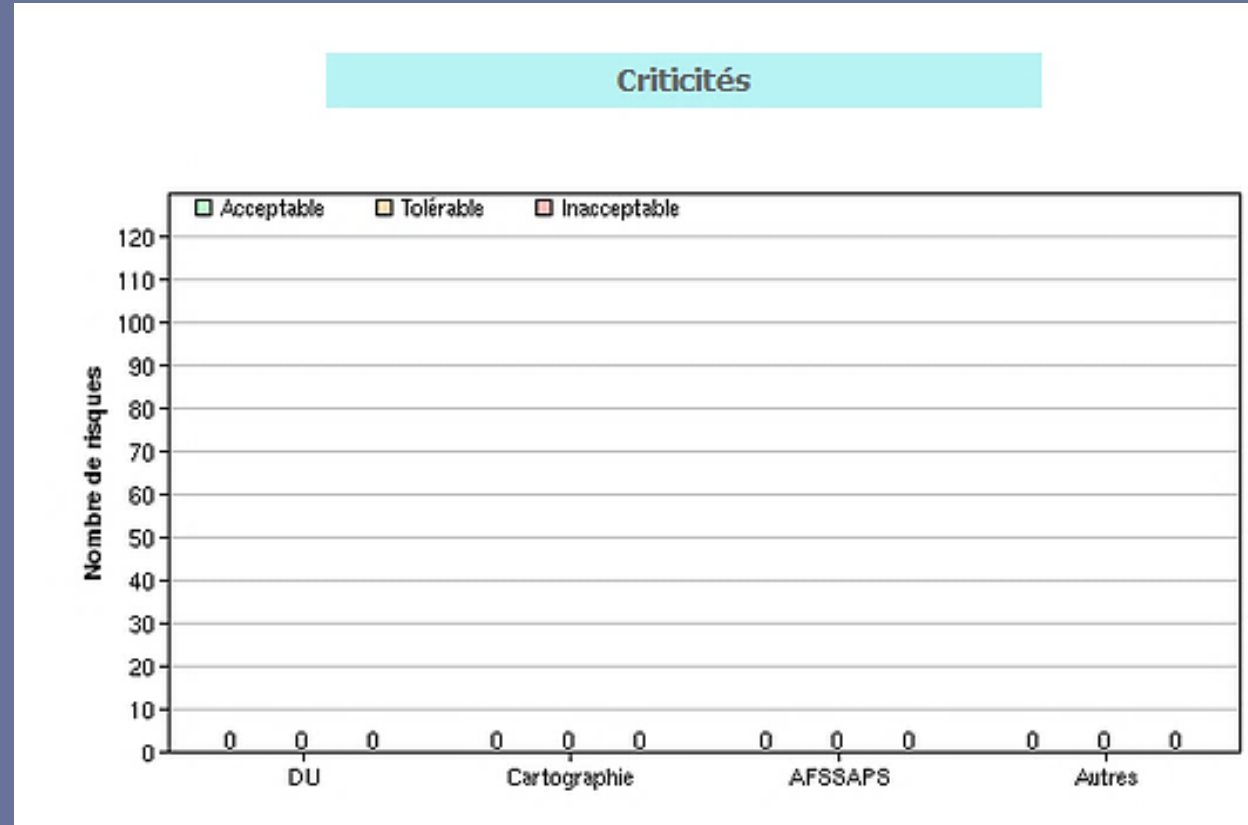

La fonctionnalité Indicateur dans Qb7 dédiée à votre METIER




Indicateur qualité

- Document
- GDR
- Analyse
- Evènement indésirable.

Indicateur de gestion technique

- Interventions
- Plannings
- Service demandeur

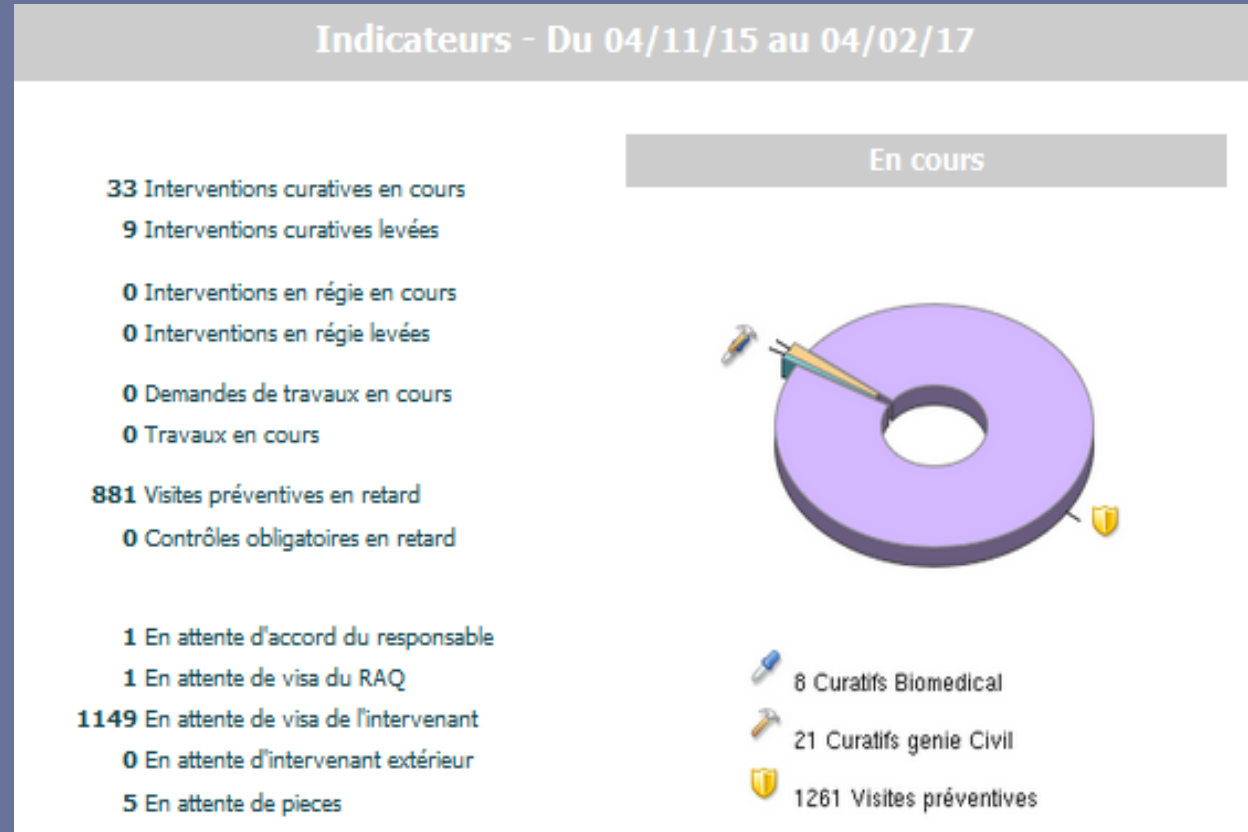

La fonctionnalité Indicateur dans Qb7 dédiée à votre METIER




Indicateur qualité


- Document
- GDR
- Analyse
- Evènement indésirable.

Indicateur de gestion technique

- Interventions
- Plannings
- Service demandeur

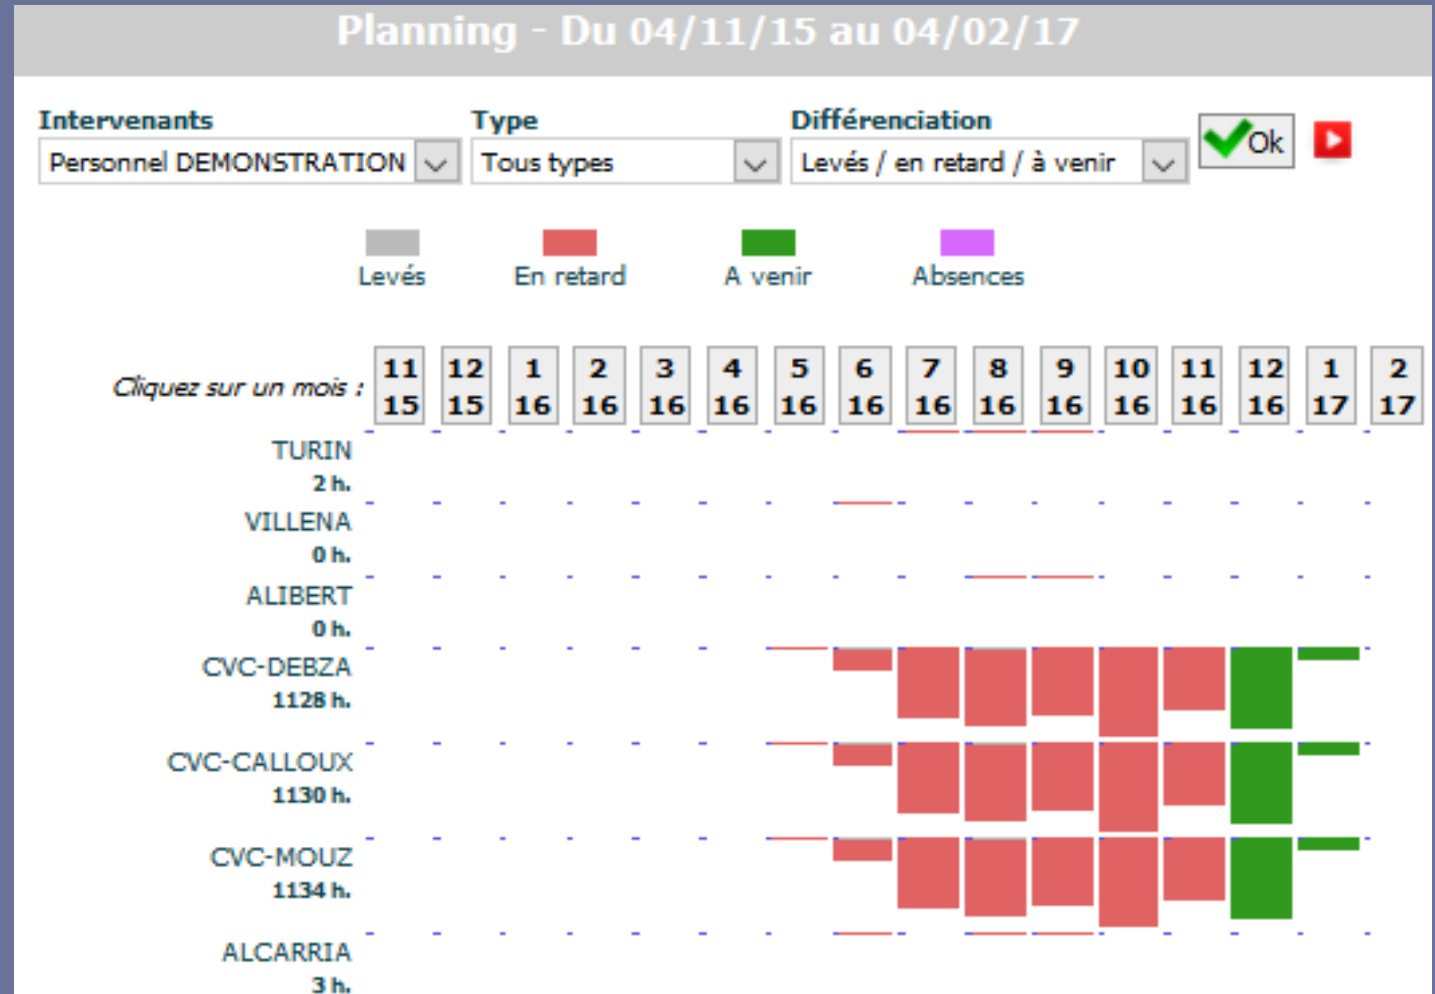

La fonctionnalité Indicateur dans Qb7 dédiée à votre METIER




Indicateur qualité


- Document
- GDR
- Analyse
- Evènement indésirable.

Indicateur de gestion technique

- Interventions
- Plannings
- Service demandeur

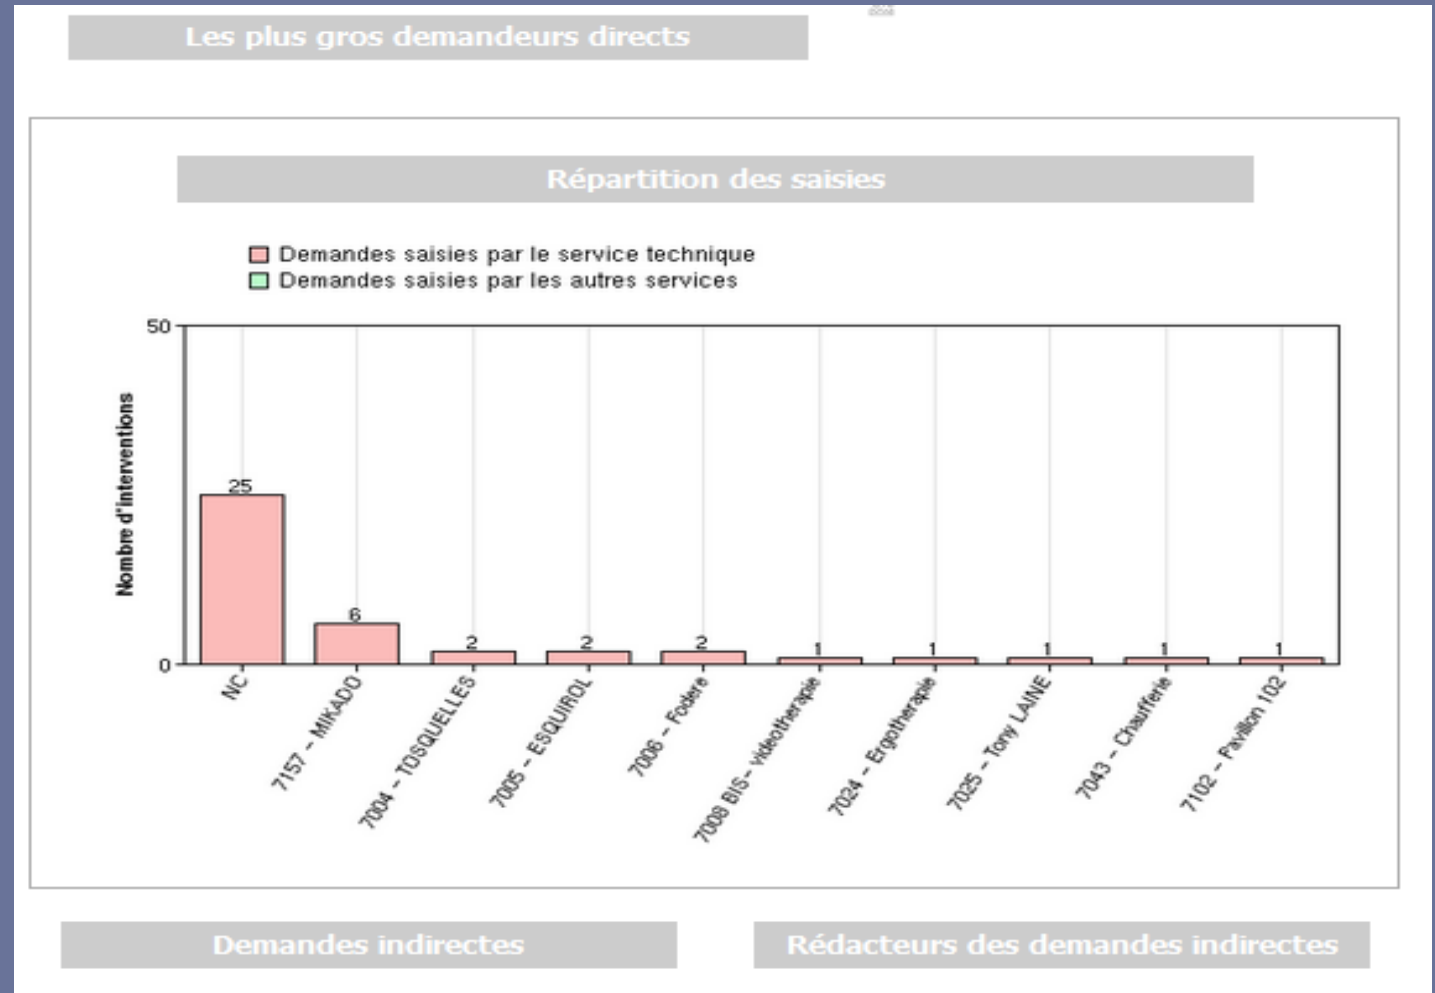

Le Modules **Plan de prévention** Qb7 dédiée à votre METIER



- Programmer
- Gamme Opératoire
- Action
- Plan

Programmation : 309 - 1602 - Generateur de Dialyse XF5621B - Tech : BOUVARD

Demandeur Qb7 Autre demandeur : IFMH

Nature Visite Préventive biomédicale

Urgence Programmé

Equipement ID Nom N° de série Modèle Recherche :
6015 1602 - Generateur de Dialyse (s/n: XF5621B - Mod: 40083)

Compteur (Compteur enregistré : 5560)

Code erreur

Equipement sous contrat
HIE EQUIPEMENT - Date de fin : le 24/05/17

Pôle Intra Bat

UF 7102 - Pavillon 102

Local 102 - Pav 1253 Salle de soins

Intervenant BOUVARD Nicolas

Prise en compte

Date effective à

Déplacement 0 h.

Diagnostic 0 h.

Tests 0 h.

Durée effective h.

Statut

Description du problème

Date saisie 03 11 16 à 16 42


Date prévue 03 11 17 à 00 00

Durée prévue 4.00 h.


Important



Visite selon la gamme opératoire en vigueur

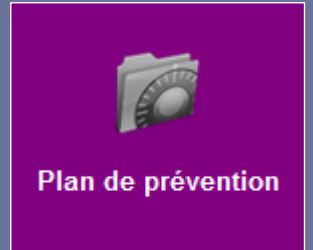Le Modules **Plan de prévention** Qb7 dédiée à votre METIER




- Programmer
- Gamme Opératoire
- Action
- Plan




05/11/18 : ID 2469 Visite Préventive biomédicale - BOUVARD 
ID 6015 : 1602 - Générateur de Dialyse - Visite selon la gamme opératoire en vigueur




05/06/16 : ID 1761 Panne biomédical - ALCARRIA 
ID 6015 : 1602 - Générateur de Dialyse - En panne 1207 

Documents associés



Parcourir... Aucun fichier sélectionné.  Insérer un rapport


Modes opératoires associés a l'équipement

  MODE OPÉRATOIRE : 013-2 Mise à disposition Materiel.xlsx 


  MODE OPÉRATOIRE : 038-1 Gestion des fournitures.doc 

Actions liés

Nom	Action à réalisée	Pièces detachées	Fréquence	Dernière date	Indice de risque	Obliga-toire	✔ Fait-le	Lien
Gamme opératoire : <i>Générateur 40085</i>								
Changement Kit A <i>Systematique</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 jour(s)	NC	1 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Changement Filtres <i>Systematique</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 jour(s)	NC	1 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	

Module Intervention avec gamme opératoire : *Générateur 40085* 

Le Modules **Plan de prévention** Qb7 dédiée à votre METIER

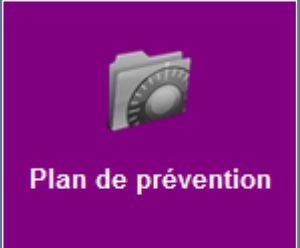













- Programmer
- Gamme Opératoire
- Action
- Plan

2016	2016	2017	2017	2017	2017	2017
						VPT Lun 01 SC:MAQUET Bloc Opératoire ALM-MAQUET
VPT Mer 02 Technique KHELILI			VPT Jeu 02 Technique KHELILI			VPT Mar 02 Technique KHELILI
VPT Mer 02 Technique ELMATEC			VPT Jeu 02 Technique ELMATEC	02 Février 2017 - Bi ID 360065 SSOL STE OSMOSEUR 1807 ELMATEC - CMS 70/500 (Technique) Entretien trimestriel suivant contrat. ELMATEC		VPT Mar 02 Technique ELMATEC
		VPT Lun 02 SC:ENGIE COFELY AXIMA Technique ENGIE AXIMA				
		VPT Lun 02 SC:ENGIE COFELY AXIMA Technique ENGIE AXIMA				
		VPT Lun 02 SC:ENGIE COFELY AXIMA				

Le Module **Stock** Qb7 dédiée à votre METIER



Logistique

Familles			
 consommable DM	 CONSOMMABLE INFORMATIQUE	 Consommables entretien	 Electricité
 Electricite (Domotique)	 Electricité (piles)	 Electricité lampes	 Filtration
 Fournitures de bureau	 Petit matériel médical	 pièce détachée DM	 Plomberie

- Familles
- Fournisseur
- Commande
- Commande interne
- Mouvement
- Restockage

Le Module **Stock** Qb7 dédiée à votre METIER



Logistique

- Familles
- Fournisseur
- Commande
- Commande interne
- Mouvement
- Restockage

Commande Fournisseur

Désignation Réappro
Magasin Principal
Nos références
Vos références
BI associé 0
UF destinataire Technique
Fournisseur CLUB NESPRESSO
Adresse : TSA 71623
Ville : PARIS CEDEX 15, 75901

Statut **En retard**
Date de commande 03 10 16
Délai de livraison 10 j
Date de livraison prévue 13 10 16
Facture validée 00 00 00
Frais fixes 0 € TTC
Ristourne 0 € TTC
TVA frais/ristourne 20
Remise globale 0 %
Commande validée le : 04/10/2016 par DACOSTA Charlotte

Mon panier

Qte	Article	Qté en Stock	Référence	Prix	Total	Qte Tot Arriv.
100	DOSETTE VIVALTO LUNGO ☀	Disponible : 250	Réf 7810.20	0,3 €HT/unité	36,00 TTC	
100	DOSETTE VIVALTO LUNGO DECAFFEINATO ☀	Disponible : 250	Réf 7646.20	0,325 €HT/unité	39,00 TTC	

62,50 €HT
75,00 €TTC

Annuler la commande Valider le panier et sortir

Le Module **Stock** Qb7 dédiée à votre METIER



Logistique

- Familles
- Fournisseur
- Commande
- Commande interne
- Mouvement
- Restockage

ACIPA

Adresse :
BP 130 - ZA LA BORIE
43120 MONISTROL SUR LOIRE (0)

Contact : *Non précisé*
Code client : C1123635
Lot : *Non précisé*

Tel : 0 471 750 750 / **Fax :** 0 471 752 752

Mail : nadine@acipa.fr
Internet : www.acipa.fr

Utilisateur : 032W8
Mot de passe : 8230203

Informations

Délais SAV annoncés : *Non précisé*
Délais livraisons annoncés : *Non précisé*
Classement : *Non précisé*

Délais livraisons effectifs : 5.1 j (13l)

Coûts

Stocks

2011	1638 TAMBOUR - TONER DR 4000		x1	106,21 €
2011	1639 TONER TN 4100		x1	89,13 €
				PUMP 195,33 €
				TTC : 195,33 €

Stocks

ID 1638 - TAMBOUR - TONER DR 4000 - (En stock : 1)

ID 1739 - TONER 64016HE - (En stock : 0)

ID 1468 - TONER CC364X - (En stock : 1)

ID 1639 - TONER TN 4100 - (En stock : 1)

Total : 3

Le Module **Stock** Qb7 dédiée à votre METIER



- Familles
- Fournisseur
- Commande
- Commande interne
- Mouvement
- Restockage

Ψ	D		NB	STOCK	DÉPART ▲	ARRIVÉE
18852	<input type="checkbox"/>	En attente	5	x5 RAMETTES PAPIER EXECUTIVE A4 80g 	- Entrée - le 13/10/16 CD	Stock Biomedical
18940	<input type="checkbox"/>	Consommation	-4	x20 CARE BAG PROTEGE BASSIN 	Chambre 225 avec douche - stock le 28/10/16 TA	- Intervention  -
18930	<input type="checkbox"/>	Consommation	-3	x500 planches ?tiquettes 66.7 x 29.75 A412 	SSOL Local Stock matériel et osmoseur le 27/10/16 SK	- Intervention -

Le Module **Stock** Qb7 dédiée à votre METIER



Logistique

- Familles
- Fournisseur
- Commande
- Commande interne
- Mouvement
- Restockage

Commande interne Qb7 - intervenants ifmH IFMH

COMMANDE N° 23

Fournisseur : <i>NC</i>	Statut : A valider N/ référence : id_commande V/ référence : Date de commande : le 31/01/16 Délai prévu : 0 Date de livraison prévue : le 31/01/16
-------------------------	---

Emetteur : IFMH
Magasin : 1130 Degagement
Destinataire : 7101 - Pavillon 101

1 CARTE DIGITAL	Réf 3456074B	4 €HT/u
-----------------	--------------	---------

Valider la commande

Valider et sortir

Envoyée

Le Module **Stock** Qb7 dédiée à votre METIER



Logistique

- Familles
- Fournisseur
- Commande
- Commande interne
- Mouvement
- Restockage

Re-stockage Qb7 - IFMH

COMMANDE N° 17

Fournisseur : <i>NC</i>	Statut : <i>A valider</i> N/ référence : id_commande V/ référence : Date de commande : <i>le 02/11/16</i> Délai prévu : 0 Date de livraison prévue : <i>le 02/11/16</i>		
Emetteur : IFMH Magasin : 1130 Degagement			
Arrivé	1 CARTE DGITAL	Réf 3456074B	4 €HT/u
Valider la commande <input type="checkbox"/>			
Valider et sortir			
Envoyée <input type="checkbox"/>			

Des supports Technologiques pour votre Maintenance

La Visio-conférence Technique intégrée à la GMAO

La Visio-Control technique qb7 Intégrée et illimitée

La Géolocalisation rfid Qb7®

Une Innovation dans le monde de la **GMAO**

GTC Qb7® le contrôle des données techniques et supervision

Nouvel interfaçages avec les SIH

Traçabilité totale des équipements DM dans le dossier Patient

Nouvel interface d'accès par les plans et les locaux dans Qb7®

Nouvel interface de gestion des Véhicules

La solution de portabilité Qb7® eazylog®

Support BIOMEDICAL intégré dans la GMAO



Le **HELPDESK Qb7** support de votre Management



Le **HQb7** Un outil qui vous libère de l'informatique pour les déclaration de panne, déclaration de vigilance, Commande de produit



Directement par téléphone sans opérateur

Une fonction importante de votre GMAO
La Création automatique des Bons d'Intervention
sur simple Appel téléphonique ou par envois de mail




Quand L'ergonomie du Logiciel de GMAO deviens un concept,

La stratégie FULL WEB ou serveur dédié Qb7





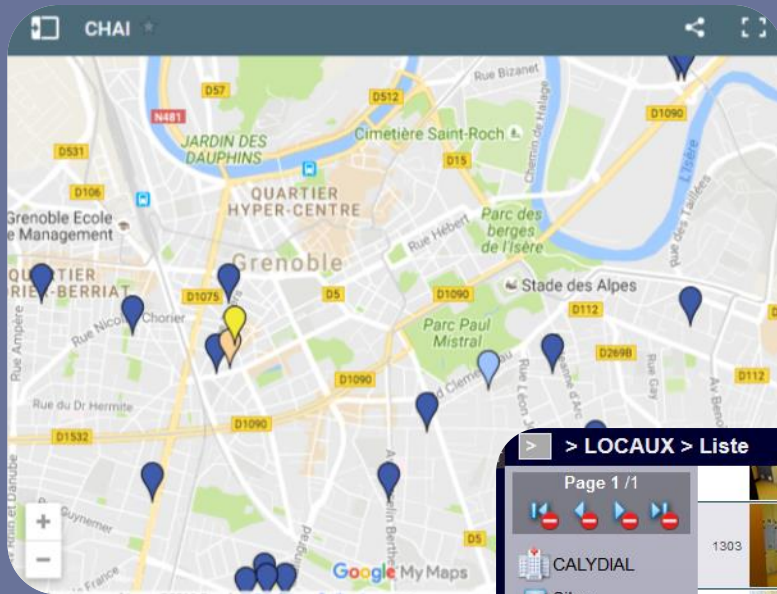


Une GMAO adaptée à votre environnement











> LOCAUX > Liste

Page 1 / 1

- CALYDIAL
- Sites
- Bâtiments
- Poles
- Services
- Locaux**
- N° 1 à 350 / 350
- Domiciles
- Contacts
- Comptes rendus
- Suivi annuel
- Indicateurs

1303		Xzzz1656 - Sanitaires hommes
1304		Xzzz1657 - Vestiaires hommes
1305		Xzzz1660 - Vestiaires femmes
1306		Xzzz1662 - Circulation
1307		Xzzz1664 - Office cuis

1381		1606 - Lit patient > N° série 1606 > Date mise en fonction 0000-00-00 00:00:00 > entreprise / Huntleigh > Fin de maintenance : NC	Dispositif médical LIT SPECIALISE 54102 R.1 ou R.12	Vienne Ancien Xzzz1501 - Dialyse
1391		1607 - Tensiomètre > N° série 1607 > Date mise en fonction 0000-00-00 00:00:00 > V700 / Dinamap > Fin de maintenance : NC	Dispositif médical LECTEUR DE TENSION ARTERIELLE 16012 R.10	Vienne Ancien Xzzz1501 - Dialyse
1386		1609 - Lit patient > N° série 1609 > Date mise en fonction 0000-00-00 00:00:00 > 460 / Contoura > Fin de maintenance : NC	Dispositif médical LIT SPECIALISE 54102 R.1 ou R.12	Vienne Ancien Xzzz1501 - Dialyse
1382		1611 - Lit patient > N° série 1611 > Date mise en fonction 0000-00-00 00:00:00 > entreprise / Huntleigh > Fin de maintenance : NC	Dispositif médical LIT SPECIALISE 54102 R.1 ou R.12	Vienne Ancien Xzzz1501 - Dialyse
1384		1613 - Lit patient > N° série 1613 > Date mise en fonction 0000-00-00 00:00:00 > entreprise / Huntleigh > Fin de maintenance : NC	Dispositif médical LIT SPECIALISE 54102 R.1 ou R.12	Vienne Ancien Xzzz1501 - Dialyse
1454		1615 - Balance > N° série 7730 > Code INT 1615 > Date mise en fonction 0000-00-00 00:00:00 > 11-0067 / SOEHNLE > Fin de maintenance : NC	Dispositif médical BALANCE STANDARD 20001 GBEA	Vienne Ancien Xzzz1501 - Dialyse
1465		1616 - Balance (NC) > N° série 1616 > Date mise en fonction 0000-00-00 00:00:00 > / Hanson > Fin de maintenance : NC	Dispositif médical BALANCE STANDARD 20001 GBEA	Vienne Ancien Xzzz1501 - Dialyse
1466		1617 - Balance (NC) > N° série 1617 > Date mise en fonction 0000-00-00 00:00:00 > / Terallon > Fin de maintenance : NC	Dispositif médical BALANCE STANDARD 20001 GBEA	Vienne Ancien Xzzz1501 - Dialyse
1467		1618 - Balance (NC) > N° série 1618 > Date mise en fonction 0000-00-00 00:00:00 > / Terallon > Fin de maintenance : NC	Dispositif médical BALANCE STANDARD 20001 GBEA	Vienne Ancien Xzzz1501 - Dialyse

> BI > Liste

Page 1 / 1

	ψ	D	U	DATE	DEMANDEUR	V	T	R	DUR	NATURE.	OBJET
3505			3	11/10/16	MEGUENNANI				¼h	Biomedical	Dysfonctionnement générateur
3504			3	10/10/16	LUC-PUPAT Pierre-Bénite UDM				¼h	Mobilier	La prise casque murale du post [...]
3401			3	26/08/16	BRONDEL Vienne Autodialyse				¼h	Exterieur	volet roulant

Bi en cours
N° 1 à 3 / 3 / 1673

- BI levés
- Codes erreur

Choisir une stratégie d'accompagnement

Une équipe support dédiée au métier de la **Néphrologie**

Assistance a la réalisation des inventaires DM DT
 Analyse de vos besoins (Schéma Structurel Technique - SST)
 Programmation des droits et profils utilisateurs dans votre
 GMAO, Tutoriels vidéo complets

Assistance, suivi et formation des techniciens
 Assistance, suivi et formation des utilisateurs
 Installation logicielle et formation des informaticiens
 Analyse des historiques de maintenance et réalisation du
 planning informatisé des Visites Préventives,
 Inventaire du mobilier certifié par commissaire au compte
 Evaluation du besoin en maintenance du Patrimoine
 Tracker **RFID – Pour localiser vos équipements au plus vite**

Assistance au déménagement de DM
 Assistance et signature par ingénieur BIOMEDICAL Qb7
 Assistance et signature par ingénieur Génie Civil Qb7
 Assistance téléphonique 5/7 8h/18h



Choisir votre accompagnement, sa performance Gage de bon fonctionnement de votre GMAO



- Préparer, réaliser et suivre les inventaires
- Organiser les inventaires dans une nomenclature
- Valoriser vos inventaires
- Optimiser vos stocks



- Préparer le déploiement de la GMAO
- Préparer et former les utilisateurs
- Choisir les bons paramétrages de votre GMAO





Choisir une stratégie d'accompagnement



- Inventorier les équipements dans la GMAO,
- Enregistrer l'historique des maintenances ou RSQM 10 ans,
- Classer vos équipements
- Planifier les visites préventives sur plus de 7 années,
- Organiser la maintenance, Préparer vos Appel d'Offre

Des indicateurs spécifiques en support Financier

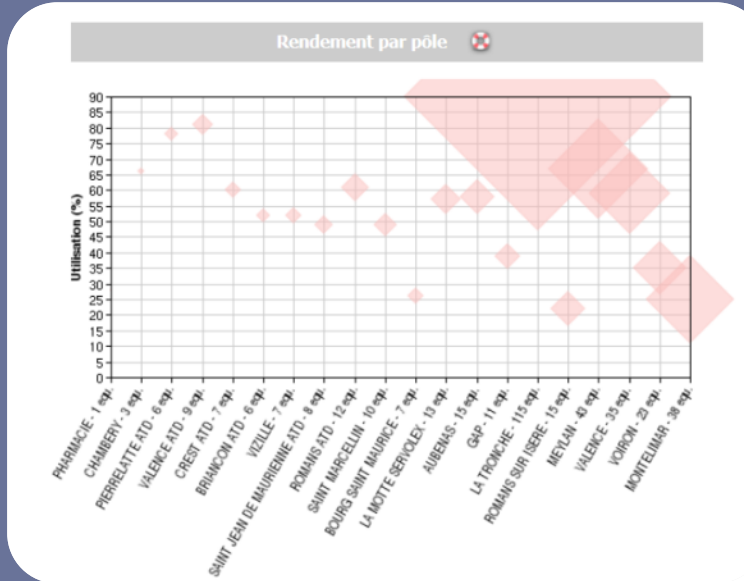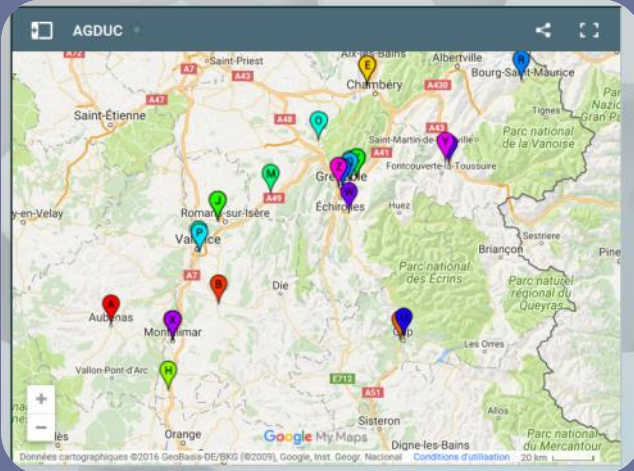

Renouvellement des équipements

Seuil d'utilisation: 85% | Filtre rendement: Pas de filtre

Nombre d'équipements pris en compte : **388**
 Nombre d'équipements sans date de MEF : 5
 Nombre d'équipements à réaffecter : **228**
 Rendement moyen : **2347 /an**

Date	Equipements à remplacer	Compteur
08/02/2015	générateurs d'hémodialyse DP ID 119 - s/n 16322 - SAINT MARCELLIN	Act : 26385 - A la date : 26385 2257 /an - 75%
08/02/2015	générateurs d'hémodialyse DP ID 118 - s/n 16291 - SAINT MARCELLIN	Act : 25312 - A la date : 25312 2166 /an - 72%

Renouvellement des équipements

Inflation: 2% | Seuil d'utilisation: 85% | Regroupement: par pôle

Ok Liste

